

Rapport d'observance SpiRi

Données résumées du 08/12/2016 12h au 05/01/2017 12h

Patient

Nom	<input type="text"/>	Date de naissance	<input type="text"/>
Prénom	<input type="text"/>	Age	<input type="text"/>
N° de dossier	<input type="text"/>	Taille (cm)	<input type="text"/>
Sexe	<input type="text"/>	Poids (kg)	<input type="text"/>
		IMC (kg/m ²)	<input type="text"/>

Commentaires

PPC

Nom	<input type="text"/>	Pression prescrite	<input type="text"/>
-----	----------------------	--------------------	----------------------

Matériel SpiRi

Module G252209040909


Activé le 06 février 2015

Mesures moyennes par nuit


Observances			
Sur les nuits d'utilisation (28)		6h27min39	
Sur toutes les nuits (28)		6h27min39	
Pression (cmH2O)			
Moyenne		12.3	
90e centile		13.2	
Débit de fuite (L/min)			
Moyenne		50.7	
Evenements (nb/h)			
Apnées	0.1	Durée totale	8 s
Hypopnées	0.7	Durée totale	1 min 04
Apnées + Hypopnées	0.8	Durée totale	1 min 12
Ignorées (fuites excessives)	0.0		

Graphiques

Durée d'utilisation




Pression

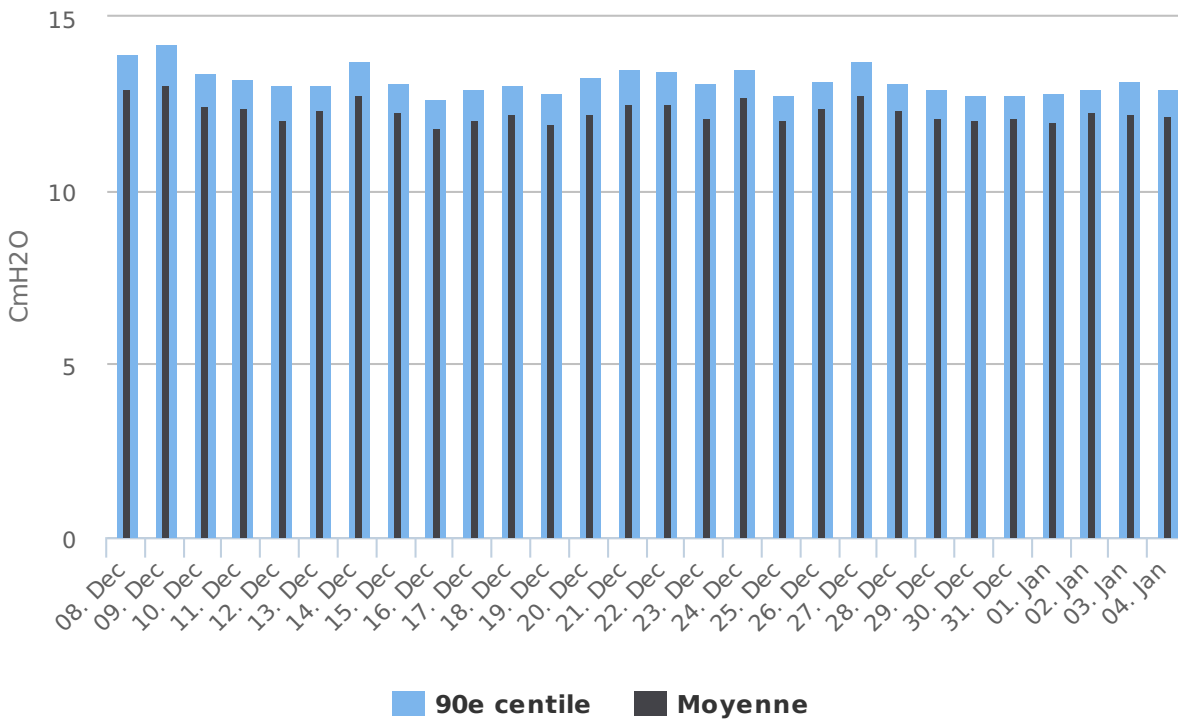


■ 90e centile ■ Moyenne

Débit de fuite



IA + IAH

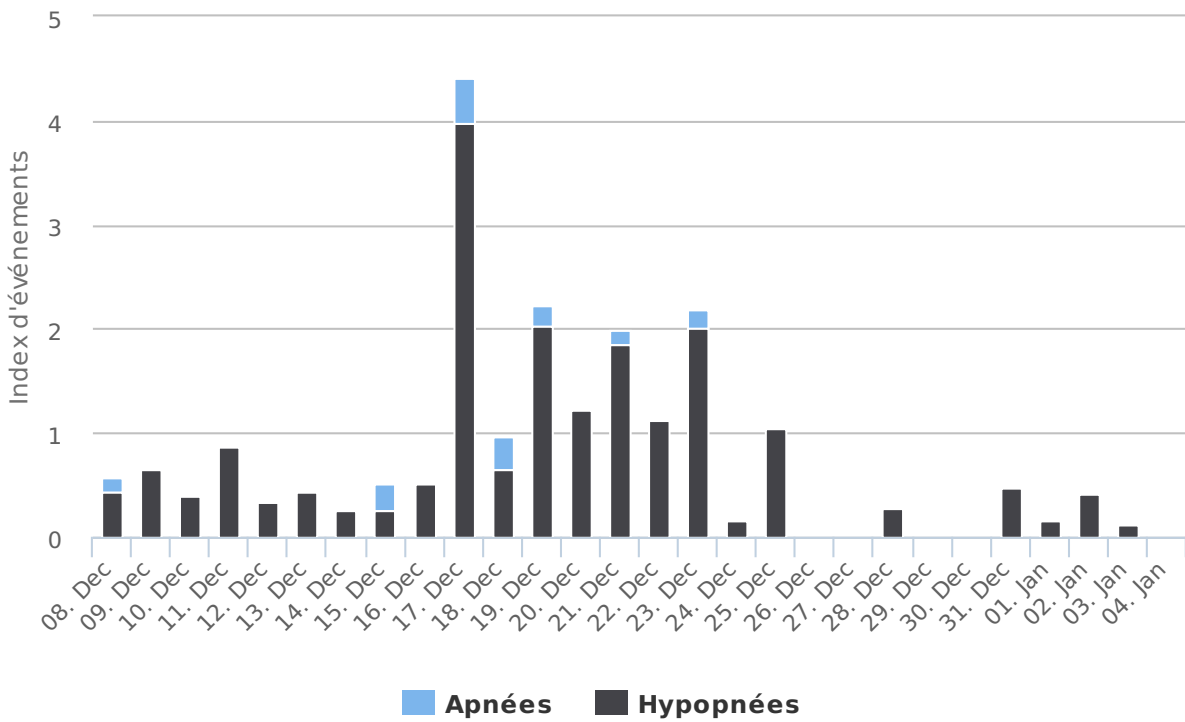

■ Apnées ■ Hypopnées